

Inhoudsopgave

Blz. 2 Voorwoord

Blz. 3 Het BIOPTIMATOR[®] systeem.

Blz. 4 Functies van de Bioptimator 1

Blz. 5 1. Kleuren Therapie

Blz. 6 2. Harmonisatie Therapie

Blz. 7 3. Frequentie Therapie volgens Prof. Dr. Hartman

Blz. 10 Bedieningsoverzicht

Blz. 11 Voorbeelden uit de Bioptimator Frequentie tabel

Blz. 12 Onderhoud
Garantie

Blz. 12 Prijslijst per 1 januari 2005

Blz. 13 Nawoord
Levering

Voorwoord

We worden omgeven door specifieke ordeningen van kosmo-energetische velden. Deze velden resoneren voor bepaalde gedeelten met de mens en de flora & fauna, hierbij hebben ze een positieve werking op levende organismen. In verschillende culturen heeft deze vorm van energie verschillende namen gekregen, zoals chi, prana, biofotonenstraling, bio-, levens- of nulpuntveldenergie.

Onderzoek heeft aangetoond dat deze fenomenen bij de mens zorgen voor een verbetering van de bio-energetische energie (levensenergie), waardoor we beter kunnen presteren en fysiek en emotioneel beter functioneren. Daardoor speelt deze oervorm van energie in de complementaire geneeskunde op het gebied van „welfare“ en „anti-aging“ een steeds belangrijkere rol.

De **Bioptimizer** biedt een unieke mogelijkheid om Bioresonantie, Kleuren en Frequentie Therapie te combineren. Deze innovatieve totaal therapie heeft een sterk harmoniserende werking op ons lichaam. Daarom wordt deze totaal therapie Harmonisatie Therapie genoemd. Door deze Harmonisatie Therapie tijdens iedere behandeling toe te passen wordt het behandelresultaat versneld en sterk verbeterd.

De energetisch therapeutische werking van de **Bioptimizer** is gebaseerd op een bio-energetische verdichtingsmodule, die het frequentiebereik van het zichtbare licht comprimeert. De veldichtheid is regelbaar en het bio-energetisch veld pulseert analoog aan de frequentie van het aardmagnetisch veld.

Bij de ontwikkeling van de **Bioptimizer** is van het volgende basisprincipe uitgegaan; ieder levend wezen, inclusief de mens, heeft een individueel trillingsbeeld dat uit harmonische (gezonde) trillingen en disharmonische (pathologische) trillingen bestaat. Met behulp van de **Bioptimizer** met de geïntegreerde verdichtingsmodule kunnen we de harmonische trillingen versterken en de disharmonische trillingen harmoniseren en opheffen. Het gevolg hiervan is dat pathologieën opgeheven worden en er een harmonisering van het individuele trillingsbeeld optreedt.

In samenwerking met Dr. Med. Joachim Colditz en Heinz Furchner zijn er velen testen uitgevoerd en is de **Bioptimizer** geperfectioneerd. De therapiekeuze en het aantal behandelingen is afhankelijk van het klachtenbeeld van de patiënt. De behandeling kan plaatsvinden door de directe toepassing van handelektroden of door het inbrengen van individuele informatiedragers van pathogene frequentiespectra zoals urine, speeksel, faeces of bloed, op basis daarvan maakt de **Bioptimizer** therapie signalen aan. De verschillende mogelijkheden worden in deze handleiding beschreven.

Het grote aantal energetisch therapeutische mogelijkheden maakt de **Bioptimizer** tot een onontbeerlijk hulpmiddel voor de **innovatieve praktijk**.

Ing. D. Schulze, de ontwikkelaar van de **Bioptimizer**.

Het BIOPTIMATOR® systeem

Het Bioptimator systeem is een bio-energetisch therapiesysteem met een nieuw gepatenteerde energie verdichtingsprincipe en een veldichtheid regeling.
Bestaande uit;

Bioptimator 1: Het basissysteem voor de praktijk.

Bioptimator 2: Therapie apparaat voor thuistherapie. De Bioptimator 1 wordt specifiek voor de patiënt geprogrammeerd waarnaar het apparaat 80 uur thuis gebruikt kan worden.

Bioptimator 3: Therapie apparaat met 2 mogelijke bio-energetische veldichtheid standen en een gleuf voor chipkaarten, die met de Bioptimator 1 geprogrammeerd zijn. Twee ingebouwde lithium batterijen zorgen dat het apparaat minstens 10 jaar goed functioneert.

Standaard toebehoren bij de Bioptimator 1:

- Bioptimator 2 en 3
- adapter gevoed door middel van zonnecellen
- netspanningssnoer
- acupunctuurpen voor kleurentherapie
- acupunctuurpen voor kleurenfrequentie therapie
- 5 chipkaarten
- 2 handelektroden
- programmeerkabel voor de Bioptimator 2
- verbindingkabel van de PC naar de Bioptimator 1

Bioptimator 2, 3 en de chipkaarten zijn na te leveren.

Stroomvoorziening

Het stroomverbruik van de Bioptimator is zeer gering. Afhankelijk van het gebruik varieert het beginvermogen tussen 0,02 en 0,5 Watt. Om storende invloeden van het stroomnet te voorkomen heeft het apparaat twee 7,2 Volt accu's. Deze accu's worden door de adapter met behulp van zonnecellen opgeladen. De zonnecellen functioneren het beste met zon- of daglicht. Normaal gesproken is het daglicht in een lichte kamer voldoende om de accu's volledig op te laden. Mocht de spanning lager worden dan 13,5 Volt dan is er feller licht nodig of kan de Bioptimator opgeladen worden via het lichtnet. In dat geval kan de oplader aan de achterkant verbonden worden met het lichtnet. Als een spanning van 14,8 á 15 Volt bereikt is kan het opladen beëindigd worden. **Langere oplaadtijden zijn ongewenst.** De spanning kan digitaal afgelezen worden als de Bioptimator aan staat.

Ingebruikname van de Bioptimator

Verbindt de adapter met de Bioptimator door de stekker in de stekkerbus naast de zekering te steken en vast te draaien. Vervolgens de schakelaar aan de achterkant op 'aan' zetten. Het groene LED aan de voorzijde gaat branden en het apparaat is gebruiksklaar.

Functies van de Bioptimator 1

De Bioptimator 1 heeft 3 behandelmogelijkheden:

1. Kleuren Therapie

- Kleuren therapie met de bio-energetische verdichtingsmodule, die het frequentiebereik van het zichtbare licht verdicht
- rechtstreekse kleuren acupunctuur, door middel van de acupunctuurpen met perfecte kleuroverdracht
- kleurfrequentie acupunctuur, door middel van de acupunctuurpen met overdracht van de kleurfrequenties

2. Harmonisatie Therapie

- overdracht van harmonische trillingen afkomstig van de oersubstantie
- het omkeren van pathogene trillingsspectra uit alle gebieden van het lichaam inclusief de organen - het versterken van de harmonische trillingsspectra, wat direct in het organisme door middel van handelektroden of acupunctuurpen plaatsvindt en het overdragen hiervan op informatiedragers, zoals een chipkaart of Vital Frequentie vloeistof
- het produceren van harmoniserende en geïnverteerde trillingen voor het opheffen van allergieën en intoleranties
- het opladen en programmeren van de Bioptimator 2 voor toepassing van thuishtherapie
- het programmeren van chipkaarten met harmoniserende of geïnverteerde trillingen voor toepassing in de Bioptimator 3
- energetische harmonisering door middel van twee handelektroden
- het invoeren van diagnostische of therapeutische frequentiespectra uit het Prognos systeem ten behoeve van omzetting in energetische harmoniserende frequenties ter behandeling van de patiënt - telkens worden harmonische trillingsfrequenties versterkt en de eventueel aanwezige disharmonische trillingsfrequenties omgekeerd, waardoor de storende invloed bij de patiënt opgeheven wordt - het effect van het therapiesignaal wordt sterk verbeterd door de verdichtingsmodule

3. Frequentie Therapie volgens Prof. Dr. Hartman.

- behandeling van patiënten met passende specifieke frequenties afhankelijk van de diagnose voor een groot aantal storingen, ingesteld volgens de indicatielijst
- frequentie therapie door middel van handelektroden, informatiedragers zoals chipkaarten of Vital Frequentie vloeistof
- frequentie therapie zoals beschreven met bio-energetische versterking

1. Kleuren Therapie

Ver terug in de geschiedenis werd in verschillende culturen de zon vereerd en werd zonlicht als therapie toegepast. Egyptische artsen gebruikten licht ter genezing. Professor Popp onderzocht de afgifte van de subtielste lichtenergie en de biofotonen, hierbij stelde hij vast dat deze biofotonen de dirigent van informatie- en sturingsprocessen in onze cellen zijn.

De Bioptimator werkt met de kleurenspectra rood, oranje, geel, groen, blauw, magenta en wit. Iedere kleur is geordend in een gedefinieerd frequentiebereik. De therapeutische werking van kleuren is intensiever dan dat de ingezette kleur **smalbandig** is.

De wetenschappelijke grondslagen volgens Professor Popp, Professor Brost en Professor Tebbe vormen de basis voor de kleurentherapie van de Bioptimator.

Absoluut nieuw in Kleuren Therapie is de modulatie van bio-energie in de licht kleurbundels.

De therapie module van het Prognos systeem geeft bij de betreffende patiënt specifieke adviezen welke kleur, acupunctuurpunt of welk reflexzonepunt het beste voor de behandeling gebruikt kan worden. Uit onderzoek is gebleken dat de directe toepassing van Kleuren Acupunctuur niet altijd beter is dan acupunctuur met kleurfrequenties. De toepassing ervan kan individueel aangepast worden.

Deze behandeling draagt zorg voor de verbetering van de energetische toestand van organen en chakra's, waardoor evenwichtsherstel bereikt wordt.

Door de betrouwbare en reproduceerbare Prognos metingen kunnen we het licht gericht en doeltreffend toepassen.

De Bioptimator heeft de volgende Kleuren Therapie mogelijkheden;

- 1.1 Rechtstreekse kleurenacupunctuur door middel van door Quartzglas geleide energetische lichtbundels.
- 1.2 Rechtstreekse kleurenacupunctuur met kleurfrequenties.
- 1.3 Overdracht van de kleurfrequenties op een informatiedrager.
- 1.4 Het vastleggen van kleurtrillingen op een informatiedrager.

Voorbeelden voor het gebruik:

1.1

Rechtstreekse Kleuren Acupunctuur met door Quartzglas geleid energetisch licht
'Colour light' schakelaar op 'On'. 'Modul power' instellen, display op 9. Vervolgens de kabel van de acupunctuurpen met de Quartzglaspunt in de linker 'Colour light' opening steken tot hij klikt. **Let op:** de lichtkabel niet knikken.

Met de 'Colour light' knop op de bovenzijde de gewenste kleur instellen. De kleur controleren in het 'Colour light' venster aan de bovenzijde. Vervolgens kunt u de acupunctuurpen op het betreffende acupunctuurpunt of reflexzonepunt zetten. Met de 'Modul power' knop regelt u de velddichtheid van het bio-energetisch veld.

Over het algemeen staat de grote velddichtheid voor een korte behandeltdijd met de acupunctuurpen, circa 10 á 20 seconden.

Zo kan er ook voor een geringere velddichtheid met een langere behandeltduur gekozen worden, die in het bijzonder geschikt is voor gevoelige patiënten.

Op de kleurfrequenties kan ook andere informatie gemoduleerd worden, door op het informatieplateau (het linker ronde plateau) een middel te plaatsen.

1.2 Rechtstreekse Kleuren Acupunctuur met kleurfrequenties

Door de acupunctuurpen met de speciale metaalpunt in de rechter 'Colour light' opening te steken (d.m.v. de bananenstekker) kunnen we op dezelfde wijze zoals beschreven bij 1.1 de Kleuren Acupunctuur met kleurfrequenties toepassen.

1.3 Overdracht van kleurfrequenties op een informatiedrager

De instellingen voor de overdracht van kleurfrequenties op een informatiedrager zijn zoals vermeld bij 1.1. U plaatst vervolgens een informatiedrager op het rechter 'Out' plateau, waardoor de informatie van de kleurfrequentie overgedragen wordt op de informatiedrager. De optimale overdrachtstijd is 3 minuten.

1.4 Het vastleggen van kleurtrillingen op een chipkaart

Zie voor de instellingen 1.1. Vervolgens een lege chipkaart in de richting van de pijl in de gleuf aan de bovenzijde van het apparaat plaatsen. Na drie minuten is de chipkaart opgeladen.

2. Harmonisatie Therapie

'Bioresonantie Therapie' is een bekende in veel varianten aangeboden methode. Het in de Bioptimator toegepaste principe is gebaseerd op een bio-energetische verdichtingsmodule, waarvan de veld dichtheid regelbaar is. Dit is principieel anders dan de gewone Bioresonantie therapie (zie het voorwoord).

Medische achtergrond: door diverse omgevingsinvloeden worden de lichaamseigen trillingen van de cellen verstoord en ontstaan er klachten en ziekten. Dit effect wordt door de Bioptimator opgeheven. Negatieve, ziekmakende trillingen worden in de Bioptimator geïnverteerd, waardoor de gezonde celfunctie kan herstellen.

Hierdoor kan met een korte behandelstijd een grote diepte werking worden bereikt.

De Bioptimator biedt de volgende Harmonisatie Therapie mogelijkheden:

- 2.1 Het produceren van harmonische oersubstantie frequentiespectra.
- 2.2 De opname van pathogene trillingsspectra en het produceren van harmonische geïnverteerde frequentiespectra (zie voorwoord).
- 2.3 Het verbeteren van allergieën en intoleranties door middel van geïnverteerde- en harmoniserings frequentiespectra.
- 2.4 Het programmeren van informatiedragers met harmoniserende en geïnverteerde frequentiespectra voor toepassing in de Bioptimator 3.
- 2.5 Het opladen en programmeren van de Bioptimator 2.
- 2.6 Harmonisatie Therapie door middel van handelektroden.
- 2.7 Het invoeren van diagnostische frequentiespectra vanuit het Prognos systeem die vervolgens omgezet worden in harmoniserende en geïnverteerde frequentiespectra.
- 2.8 Het gebruik van de Bioptimator 3.

2.1 Het produceren van harmonische oersubstantie trillingen

De oersubstantie op het linker kleine 'In' plateau plaatsen. Op rechter 'Out' plateau een informatiedrager plaatsen. Met de knop 'Modul power' de gewenste sterkte instellen (van 0 tot 12). De overdracht duurt 3 minuten. De meest gebruikelijke instelling is 9.

2.2 Opname van pathogene trillingspectra en het produceren van harmoniserende geinverteerde frequentiespectra

Stel de Modul power knop op 9 (zonodig individueel aanpassen). De stekker van de handelektrode met de blauwe kabel in de blauwe stekkerbus steken. Plaats op rechter 'Out' plateau een informatiedrager en de (hand)elektrode op het probleemgebied. Na 3 minuten is de informatiedrager opgeladen met de harmoniserende geinverteerde frequentiespectra.

Het is ook mogelijk om met beide elektroden 'Totaaltherapie' te geven. Door middel van één elektrode in de linker en één in de rechter hand te nemen met het apparaat op de gewenste instellingen vindt dan algemene therapie plaats.

Let op: Bij vrouwen moet de elektrode met de blauwe kabel in de linker hand en met de rode kabel in de rechter hand. Bij mannen andersom. Het kruisen van de kabels met kabelcontact moet vermeden worden.

2.3 Het verbeteren van allergieën en intoleranties door middel van geinverteerde en harmonisering frequentiespectra

Stel de 'Modul power' knop op 9 (zonodig individueel aanpassen). Het allergeen op het linker 'In' plateau plaatsen. De pathologische allergie- en intolerantie frequentiespectra bevinden zich ook in het bloed, speeksel of in de urine van de patiënt. Dit houdt in dat deze substanties ook op het 'In' plateau geplaatst kunnen worden in een ampul of schaalpje van helder glas. Vervolgens wordt de informatiedrager op de rechter 'Out' plateau geplaatst. Na 3 minuten is de overdracht klaar. De informatiedrager bevat nu geinverteerde frequentiespectra van het allergeen en harmonisering frequentiespectra. Het effect wordt bereikt door een Vital Frequentie flesje op deze wijze te programmeren. De Patiënt neemt gedurende 4 weken drie maal per dag 5 druppels van deze vloeistof in.

Een andere mogelijkheid is met beide handelektroden therapeutisch te behandelen. De stekker van de handelektrode met de blauwe kabel in de linker stekkerbus en de handelektrode met de rode kabel in de rechter stekkerbus. De 'Modul power' knop op 9 instellen (of individueel aanpassen). Via de blauwe kabel (ingang) worden de pathologische frequenties opgenomen in de Bioptimator en veranderd in een geinverteerde en harmonisering frequentiespectra, die via de rode kabel naar de patiënt geleid wordt.

Let op: Bij vrouwen moet de elektrode met de blauwe kabel in de linker hand en met de rode kabel in de rechter hand. Bij mannen andersom. Het kruisen van de kabels met kabelcontact moet vermeden worden.

2.4

Het programmeren van chipkaarten met willekeurige, geïnverteerde en harmoniserende frequentiespectra (voor toepassing in de Bioptimator 3)

Chipkaart uit de verpakking halen en in de richting van de pijl in de gleuf steken. De 'Modul power' knop op 9 zetten. Plaats op het linker 'In' plateau de oorspronkelijke substantie (ook allergenen) en na 3 minuten is de chipkaart opgeladen. De chipkaart nog een keer opladen is niet aan te bevelen.

2.5

Het opladen en programmeren van de Bioptimator 2

Steek de stekker van de verbindingkabel van de Bioptimator 2 in de 'Program' ingang aan de achterzijde van de Bioptimator 1. Met de 'Program' knop de programmering sterkte instellen. Bij voorkeur op stand 9.

Aanvullende informatie wordt op het linker 'In' plateau gezet gedurende 3 minuten. Vervolgens wordt de 'Program' knop op de bovenzijde van de Bioptimator gedurende 5 seconden ingedrukt, waardoor het LCD scherm van de Bioptimator 2 kort oplicht en het programmeren ten einde is.

Indien het LCD scherm niet oplicht dan moet de Bioptimator 2 eerst ontladen worden door de 'Program' knop op 0 te zetten en vervolgens de 'Program' knop op de bovenzijde 20 seconden in te drukken. Daarna kan de Bioptimator 2 opnieuw opgeladen worden. De Bioptimator 2 is vooral geschikt om energietekorten te verbeteren. Dagelijks behandelen van bijvoorbeeld de Thymus, 2 maal gedurende 5 á 10 minuten, is zinvol.

De goudkleurige (eivormige) elektrode moet gericht worden op het te behandelen zone gebied. Met de clip kan het apparaat aan de kleding bevestigd worden. Het elektrode oppervlak mag geen huidcontact maken.

2.6

Energetische Therapie met handelektroden

Zie voor de plaatsing van de elektroden 2.3. Het is ook mogelijk een **energieoverschot** af te voeren door middel van therapie met 2 handelektroden. Zet de 'Modul power' knop op 9 en verbindt de blauwe kabel met de rode stekkerbus en de rode kabel met de blauwe stekkerbus. Voor vrouwen de blauwe elektrode nu in de rechter hand, voor mannen in de linker hand (bij de normale therapie is dit andersom).

Geven we de patiënt de elektroden andersom in de hand dan is er weer sprake van de zogenaamde algemene therapie en wordt de energie juist opgeladen. Met behulp van het Prognos systeem kan het effect van deze behandeling gemeten worden.

2.7

Het invoeren van diagnostische frequentiespectra vanuit het Prognos Diagnose systeem om deze vervolgens om te zetten in energetische harmoniserende geïnverteerde frequentiespectra

De verbindingkabel aan de achterzijde van de Bioptimator via de vergulde knop moet verbonden worden met de geluidsuitgang van de computer om zodoende de Prognos frequenties op te kunnen pikken. De Modul power knop op 3 instellen. Plaats de informatiedrager op rechter 'Out' plateau, die de voor de patiënt passende therapie informatie uit het Prognos systeem opneemt, om zo ten einde harmonisatie bij de betreffende patiënt te bewerkstelligen.

Met behulp van het juiste signaal geprogrammeerde Vital Frequentie kan later door het toevoegen van druppels aan drinkwater deze informatie overgedragen worden op dit drinkwater. Dat vervolgens verdeeld over de dag wordt opgedronken.

Vervolgens kan ook de algemene Harmonisatie Therapie met de diagnostische frequentiespectra toegepast worden, met behulp van de twee handelektroden gedurende 5 á 10 minuten. **Let op:** de juiste positionering van de handelektroden bij mannen en vrouwen, energie overschot of tekort. Een Prognosmeting na het toepassen van de Harmonisatie Therapie toont snel de opgetreden energetische veranderingen.

2.8

Het gebruik van de Bioptimator 3

De Bioptimator 3 is een patiëntenapparaat. Het heeft een 2 standen veld dichtheidsregeling en is vooral geschikt voor de behandeling van energie tekorten. De patiënt kan 2 maal per dag gedurende 10 minuten het Thymus gebied bestralen met de goudkleurige elektrode in de richting van de Thymus.

Aanvankelijk het apparaat instellen op stand 1 en na enige dagen op stand 2 (individueel te bepalen).

De Bioptimator 3 heeft een chipkaart ingang waar een individueel geprogrammeerde chipkaart ingeschoven wordt. Door middel van de clip kan het apparaat aan de kleding bevestigd worden, waarbij wederom direct huidcontact vermeden moet worden.

3. Frequentie Therapie volgens Prof. Dr. Hartman

Gedurende jarenlang onderzoek heeft Prof. Dr. Hartman het frequentiespectra uitgetest en de werking er van vastgesteld. Het hele organisme en alle ermee verbonden functies worden hersteld. Voor behandelaars is er een zeer uitgebreide indicatielijst. In deze syllabus worden een aantal voorbeelden genoemd. Met behulp van vier knoppen kunnen frequenties van 0 tot 100 Hz ingesteld worden (twee cijfers voor en twee achter de komma).

Let op: na afloop van de therapie deze vier knoppen op 0 zetten.

3.1

Frequentie Therapie

Voor het toepassen van de Frequentie Therapie zet u de Bioptimator 1 aan en de 'Modul power' knop uit. Aan de hand van de indicatielijst stelt u met behulp van de vier knoppen, aan de voorzijde van het apparaat, de juiste frequentie in. Deze frequentie wordt met behulp van de handelektrode met de rode kabel en de stekker in de rode stekkerbus naar de patiënt geleid.


Let op: vrouwen elektrode in de rechter hand, mannen in de linker hand.

De behandeltijd is 7 minuten.

Het is ook mogelijk de frequentiespectra op een informatiedrager over te zetten, door de informatiedrager op rechter 'Out' plateau te plaatsen. De tijdsduur voor de overdracht is ongeveer 3 minuten. Stel altijd eerst nauwkeurig de frequentie in, plaats de informatiedrager op het 'Out' plateau of plaats de chipkaart in de gleuf en zet dan de schakelaar op 'On'. Voor het optimaliseren van de therapie kunt u de methode met de handelektrode en met de informatiedrager toepassen.

3.2 Frequentie Therapie met bio-energetische versterking

Deze functie moduleert de frequentie therapie met bio-energie. Voor het gebruik van deze functie wordt dezelfde procedure gevolgd als bij 3.1, alleen de „Modul power“ schakelaar wordt op 5 gezet. De behandel tijd bedraagt in alle gevallen 7 minuten.

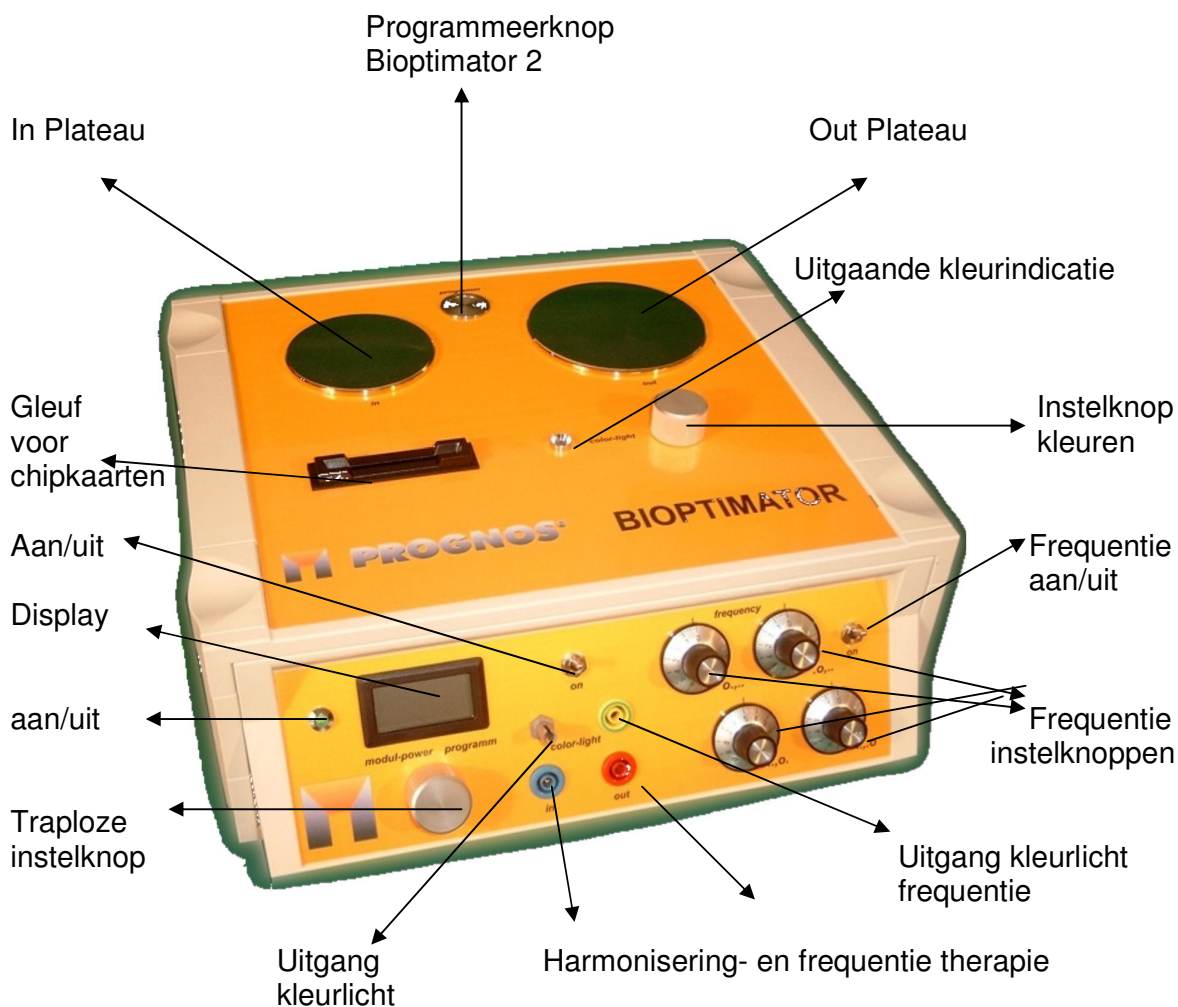

Op de achterzijde zijn aansluitingen voor de zonnecel, de programmering van de Bioptimator 2 en de ingang vanaf de PC voor vitaal frequenties vanuit de Prognos software.

Voorbeelden uit de Bioptimator Frequentie tabel

Hieronder vindt u een selectie uit een zeer groot aantal indicaties en toepassingen.

Pesticiden		Organisch chemische giften	
Acaricide (tegen mijt)	81,4415	Benzanthrazen	59,32
*Fungicide (tegen schimmels)	75,4141	Cortison	77,45
		Formaldehyde	76,34
		Xyladekor 2000	26,41
Mineraalzouten		Bacteriële belastingen	
Calcium fluoratum	96,60	Borrelia burgdorferi	85,4352
Natrium sulfuricum	76,36	Meningococcon	55,4141
Arsenum jodatum	92,50	Streptococcon viridans	55,2156
Zincum chloratum	91,40		
Orgaan preparaten		Schimmel belastingen	
Aorta	55,40	Actinomyces israelii	55,44
Arteria	65,14	Scopulariopsis brevic.	76,22
Nervus facialis	58,55	Tryptophanum	53,42
Nosoden		Gist belastingen	
Blaas papilloma	58,44	Candida albicans	38,65
Dunne darm	54,38	Trichosporon cutaneum	51,45
Mamma sarcoom	85,23		
Ventrikel cirrhosis	54,45	Symptomen/ziekten	
		Eczeem	75,48
Ontstekingshaarden/toxicosen		Libidoverlies	76,70
Periproctisch abces	79,45	Migraine	85,72
Acute adnexitis	59,45	Soor	85,55
Cyste kaakholten	75,35	Cystitis	69,66
Chronische prostatitis	69,58		
Acute pulpitis	99,28	Virale belastingen	
Wortelkanaalbehandeling	95,35	Chlamydia trachomatis	37,4525
Tandfistel	51,44	Coxsackie A2	89,3162
		Epstein Barr	38,0461
Kinderziekten		Influenzinum vesiculosum	45,4212
Angina follicularis	55,55	Varicella virussen	75,4263
Mazelen	72,50		
Rodehond	35,50	Parasitaire belastingen	
Waterpokken	59,11	Ascariden larven	35,10
		Ascariden lumbricoïden	57,10
Toxische metaalbelasting		Ascariden	51,10
Amalgaam	95,42	Trichomonaden	74,40
Kalium	69,42		
Plumbum	83,60	Acupunctuur relaties	
Zincum	75,32	Hart	62,54
		Dunne darm	63,42
Konstitutie middelen		Homeopatische miasmen	
Arnica montana	84,60	Carcinosinum	85,45
Thuja occidentalis	58,50	Typhus	90,45
Zincum metallicum	85,80		
Sulfur	46,10	Homeopatische bereiding bij vegetatieve storingen	
		Acidum phosphoricum	95,70
		Carboneum sulfuratum	79,44
		Tuberculinum	90,20
		Cannabis indica	75,73
		Lycopodium	55,51
		Zincum metallicum	68,45

Let op: de vermelde frequenties en de genoemde toepassingen zijn uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik met de Bioptimator bestemd. Het verspreiden van deze gegevens onder derden in welke vorm dan ook is niet toegestaan.

Meer informatie over de indicaties (lijst met 705 specifieke Hartman-frequenties) en de toepassingen van Frequentie Therapie kunt u op aanvraag verkrijgen bij Prognos Nederland BV.

Onderhoud

Let op: dat indien u het apparaat langere tijd niet heeft gebruikt de accu opgeladen is. Dit kan bewerkstelligd worden door de zonnecellen in een lichte omgeving te plaatsen. Zorg er voor dat de 'In' en 'Out' plateaus niet met krassende voorwerpen of bijtende vloeistoffen in aanraking komen. De plateaus uitsluitend met een zachte poetsdoek oppoetsen. Scherm het 'Out' plateau met levensmiddelen folie af.

De Bioptimator verdraagt temperaturen tussen 10 en 40 graden. Het apparaat functioneert optimaal bij kamertemperatuur.

Bij problemen wendt u zich tot uw leverancier.

Garantie

De Bioptimator heeft een garantietermijn van 1 jaar vanaf de verkoopdatum. Binnen de garantieperiode worden storingen die het gevolg zijn van materiaal- of productiefouten kosteloos verholpen. Uitgesloten van garantie zijn krassen op de elektroden of beschadiging door inwerkend geweld. Eigenhandig openen van de apparaten leidt tot het vervallen van de garantie.

Prijslijst per 1 januari 2005

Bioptimator basissysteem 1

Nieuwe uitvoering 2005.

Apparaat compleet met Harmonisatie Therapie, Licht Therapie, Frequentie Therapie en toebehoren. Incl. Bioptimator systemen 2 en 3 alles tesamen in een degelijke koffer..... € 6750,00

Bioptimator 2

therapie apparaat voor thuistherapie..... € 389,00

Bioptimator 3

therapie apparaat voor thuistherapie inclusief lithium batterij en ingang voor chipkaarten..... € 419,00

Chipkaarten

per 10 stuks..... € 75,00

Prijzen zijn exclusief 19 % BTW.

Betaling: netto bij levering of zoals overeengekomen.

Nawoord

Met de Bioptimator heeft u een apparaat in handen met zeer veel therapeutische mogelijkheden. De beschreven functies en instellingen, zoals oa. de behandel tijden, zijn slechts richtlijnen. Optimale behandelresultaten verkrijgt u door de toepassingen af te stemmen op de individuele patiënt. In combinatie met uw eigen ervaring en behandel mogelijkheden zal de Bioptimator in veel gevallen tot een snel en goed behandelresultaat leiden.

Behalve de beschreven toepassingsmogelijkheden zijn er nog vele andere varianten te bedenken.

Let op: het Bioptimator systeem kan aanvullend, ondersteunend, ter optimalisatie en preventief bij acute en chronische klachtenbehandelingen ingezet worden. De toepassing bij bepaalde symptomen, de verdraagzaamheid, de behandel tijden en de intensiteit zullen ten allen tijden vakkundig door de behandelaar vastgesteld moeten worden.

Voor meer informatie:

Levering

Prognos Nederland BV
Energieweg 5
3281 NH Numansdorp
T +31(0)186 680 670
F +31(0)186 681 350
M +31(0)6 535 864 95
info@bioptimator.com
www.prognos.info